

Продолжение протокола № 2489

Код образца (пробы): 2.20.2489.Д

17. Средства измерений, испытательное оборудование

№ п/п	Тип прибора	Номер в Госреестре	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об испытании	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТСВЛ-160	—	2020	2341220190011	135	40/5	28.01.2021г
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	—	1982	ВА0000000024/5	7864	805/5	10.10.2020г

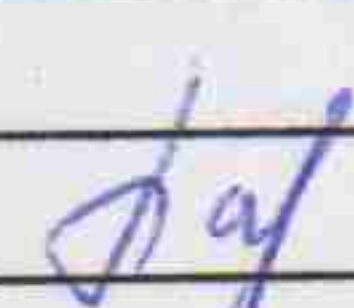
18. Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
535	Общее микробное число	0	не более 100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	бактерий в 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	бактерий в 100 мл	

Дата проведения исследований с 05.10.2020г по 06.10.2020г

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог	Фадякина Г.Н.	

Составлено в трех экземплярах

Общее количество страниц: 3 страница: 3